



لیزر  
آگزایمر

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران  
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



## بهبود خواص سطحی و آنالیز میکروسکوپی لنزهای تماسی چشم تحت پرتودهی با لیزر آگزایمر

طیبه آریافر<sup>۱</sup>, پیمان تجلی<sup>۱</sup>, علی پوراکبر صفار<sup>۲,۴</sup> و حبیب تجلی<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آ. شرقی، گروه فیزیک

<sup>۲</sup> تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه فیزیک و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

<sup>۳</sup> تبریز، دانشگاه تبریز، قطب علمی فوتونیک

<sup>۴</sup> تهران، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، آزمایشگاه لیزر

چکیده - در این مقاله لنزهای تماسی سخت نافذ گاز (RGP) با قطر ۹/۶ mm به وسیله لیزر آگزایمر با طول موج ۱۹۳ nm، در نرخ تکرار ۱ Hz و انرژی تپ ۷۵ mJ/pulse تا شار انرژی ۱/۹ J/cm<sup>2</sup> تحت پرتودهی قرار گرفته اند. آنالیز و مشخصه یابی قبل و پس از پرتودهی با استفاده از اندازه گیری زاویه تماس برای تعیین میزان رطوبت پذیری، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) به همراه آنالیز زیری سطح، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی تبدیل فوریه فرو سرخ (FTIR) انجام شده است. مطابق نتایج، پرتودهی لیزری بدون ایجاد تغییر در باندهای شیمیایی، مشخصات سطحی لنز را بهبود بخشیده و آب دوستی سطح لنز را افزایش داده است.

کلید واژه- طیف سنجی، لنز تماسی، لیزر آگزایمر، میکروسکوپ اتمی، میکروسکوپ الکترونی

## Surface modification and microscopic analysis of eye contact lenses treated by excimer laser

Tayebeh Ariyafar<sup>1</sup>, Peyman Tajalli<sup>1</sup>, Ali Pourakbar Saffar<sup>2,4</sup> and Habib Tajalli<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Physics Department, Islamic Azad University East Azarbaijan Science and Research Branch, Tabriz-Iran

<sup>2</sup>Physics Department, Islamic Azad University Central Tehran Branch, and Young Researchers Club & Elites, Tehran-Iran

<sup>3</sup>Excellence in Photonics, University of Tabriz, Tabriz-Iran.

<sup>4</sup>Laser Laboratory, Research center of Informatics Industries, Tehran

Abstract- In this work, RGP contact lenses with 9.6 mm diameter were exposed by 193 nm ArF excimer laser, at 1 Hz pulse repetition rate with 75 mJ/pulse energy about 1.9 J/cm<sup>2</sup>. Characterization and analysis techniques was performed via contact angle measurement in order to determine surface wettability, Atomic force microscopy (AFM) with roughness analysis, Scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infra-red spectroscopy (FTIR). According to the results, the laser irradiation without changing the chemical bonds has modified lens surface properties and increased the surface hydrophilicity.

Keywords: AFM, Excimer Laser, RGP Lens, SEM, Spectroscopy

ایجاد تغییری در ساختار شیمیایی پلیمر، بهبود یافته است [۶].

بهبود خواص سطحی لنز سخت RGP توسط پلاسمای سرد انجام شده است که در نتیجه زاویه تماس این لنز را از ۶۹ درجه به حدود ۴۰ درجه کاهش داده و در اصل میزان رطوبت پذیری را افزایش داده است. همچنین میزان زبری سطح در اثر تابش پلاسما که به وسیله میکروسکوپ اتمی اندازه گیری شده است کاهش یافته است [۷].

## ۲- روش آزمایش

لنز تماسی سخت به شکل دایره ای به قطر  $9/6\text{ mm}$  می باشد. لیزر اگزایمر آرگون فلوراید (Lambda Physik, LPX210) با طول موج  $193\text{ nm}$ ، با انرژی تپ  $1\text{ Hz}$ ، طول پالس  $10\text{ ns}$  و نرخ تکرار پالس  $1\text{ Hz}$  به عنوان یک منبع فرابنفش همدوس استفاده شده است. مورفولوژی غشا با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (Nanowizard, JPK, Germany) و میکروسکوپ Seron Technology AIS2100 (بررسی شده است. چون سطوح پلیمری رسانایی الکتریکی ندارند، قبل از تصویربرداری SEM یک لایه  $10\text{ nm}$   $15\text{ nm}$  طلا با پوشش دهنده پرتاپی روی سطح لنز روکش شده تا بار الکتروستاتیک به واسطه اشعه الکترونی از سطح برداشته شود. آب دوستی و قابلیت رطوبت سطح لنزها را از طریق اندازه گیری زاویه تماس با استفاده از دستگاه زاویه سنج (Kruss G10) که مجهر به نرم افزار تحلیل کننده تصویر می باشد و با روش قطره چسبنده محاسبه شده است. طیف ATR/FTIR تمامی نمونه ها با استفاده از طیف سنج (BRUKER-EQUINOX 55) در محدوده طول موج  $4000\text{ cm}^{-1}$  ثبت شده است.

## ۳- بحث و نتایج


شکل های ۱ و ۲ میکروساختارهای حاصل از کندگی توسط لیزر اگزایمر در  $10\text{ }\mu\text{m}$  و  $20\text{ }\mu\text{m}$  را نشان می دهند که این میکروساختارها سطح را در دوزهای بالاتر لیزری به تدریج می پوشانند. سطح لنز با افزایش دوز لیزر تا  $20\text{ }\mu\text{m}$

## ۱- مقدمه

لنזהای تماسی سخت اولین بار در سال ۱۹۶۰ از ماده ای به نام PMMA ساخته شدند که دارای زاویه تماس ۶۰-۷۵ درجه بودند، اما امروزه به ندرت استفاده می شوند. امروزه از لنزهای سخت نافذ گاز (RGP) به عنوان جایگزینی برای لنزهای سخت قبلی استفاده می شود. در ساخت این لنزها پلی متیل متاکریلات SMA و یا پلیمر های فلوئوروسیلیکون اکریلات FSA ترکیب می کنند تا علاوه بر شکل گیری مناسب، قدرت عبور اکسیژن را نیز داشته باشند. این لنزها نسبت به لنزهای سخت قدیمی، رطوبت پذیری بالاتری دارند و راحت ترروی چشم تنظیم می شوند. زمانیکه قرنیه آستیگماتیسم دارد، لنزهای سخت نافذ اکسیژن بهترین انتخاب هستند، زیرا لنزهای نرم قادر نیستند آستیگماتیسم را اصلاح و بینائی شفافی به فرد بدهنند [۱].

از انواع فناوری اصلاح سطوح پلیمری که بر اساس تابش در محدوده فرابنفش انجام می شود فرایند فوتولیمیریزاسیون می باشد که در این بین می توان لیزرهای اگزایمر در این محدوده طول موجی بین  $100\text{ nm}$   $400\text{ nm}$  را به کار برد. پس از اصلاح سطح از روشهای طیف سنجی گوناگونی مثل طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) برای شناخت ساختار جدید و مقایسه آن با ساختار اولیه سطح قبل از اصلاح استفاده می کنند [۴-۲]. ساده ترین آزمایش برای شناخت ویژگی های مربوط به عملکرد سطح پلیمرها اندازه گیری میزان رطوبت پذیری آنها می باشد، که تکنولوژی رایج برای این اندازه گیری روش اندازه گیری زاویه تماس می باشد. در میان روش های به کار گرفته شده برای آنالیز مواد، با استفاده از روش های میکروسکوپی بخصوص SEM و AFM تصاویری با بزرگنمایی بسیار بالا از ماده بدست می آید.

بررسی زبری و سختی سطح پلیمر PMMA پس از تابش با لیزر گازی اگزایمر برای تاثیر در میزان دید انجام شده است که در نتیجه تابش لیزر سطح پلیمرهای موارت شده است [۵]. رطوبت پذیری سطح پلیمر PMMA با تابش لیزر فمتوثانیه ای تیتانیم سفایر  $\text{Ti:Sapphire}$ ، بدون

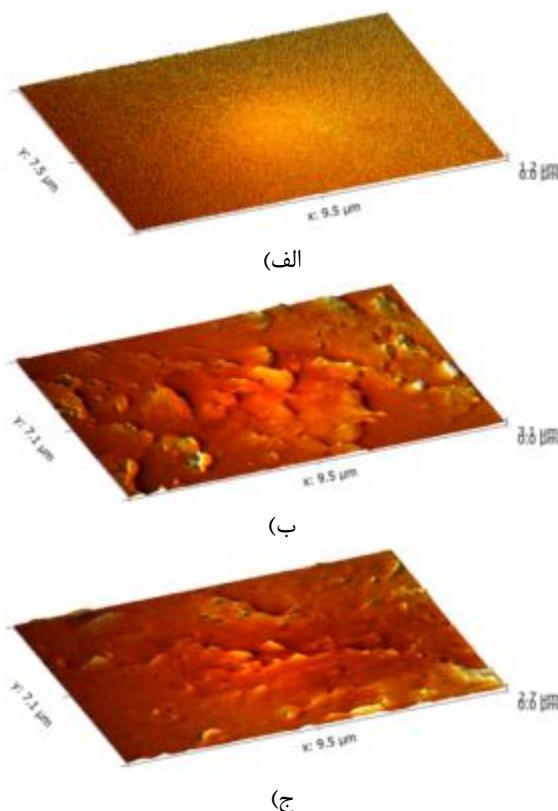

شکل ۲. میکروگراف های AFM لنز تماسی (الف) مرجع،  
ب) پرتودهی با ۱۰ ، ج) ۲۰ پالس


زیری سطحی با استفاده از میکروگراف های AFM و به وسیله دو پارامتر یعنی زیری ریشه میانگین مربعی  $R_{rms}$  و زیری میانگین  $R_a$  اندازه گیری شده است. جدول ۱ نتایج زیری سطحی محاسبه شده را برای سطح مقاطع لنزهای مرجع و پرتودهی شده به ابعاد  $9.5 \times 7.1 \mu\text{m}^2$  نشان می دهد.

جدول ۱. زیری سطح لنز قبل و پس از پرتو دهی

تعداد پالس	۰	۲	۵	۱۰	۲۰
شار $\text{J/cm}^2$	۰	۰/۱۷	۱/۴۷۵	۱/۹۵	۱/۹
$R_a (\text{nm})$	۱۰۶	۱۷۱	۳۰۱	۲۶۰	۱۹۲
$R_{rms} (\text{nm})$	۱۳۲	۲۹۴	۴۲۶	۳۵۰	۲۷۱

طیف FTIR لنز مرجع و لnzی که با ۲۰ پالس مورد پرتودهی قرار گرفته اند در شکل ۳ نشان داده شده است. ساختار شیمیایی نمونه ها قبل و پس از پرتودهی تقریباً بر یکدیگر منطبق می باشند، که نشان می دهد باند

پالس به صورت لایه لایه روی هم قرار می گیرند و سطح اصلی را می پوشانند و در نتیجه سطح هموارتری را تولید می کنند.

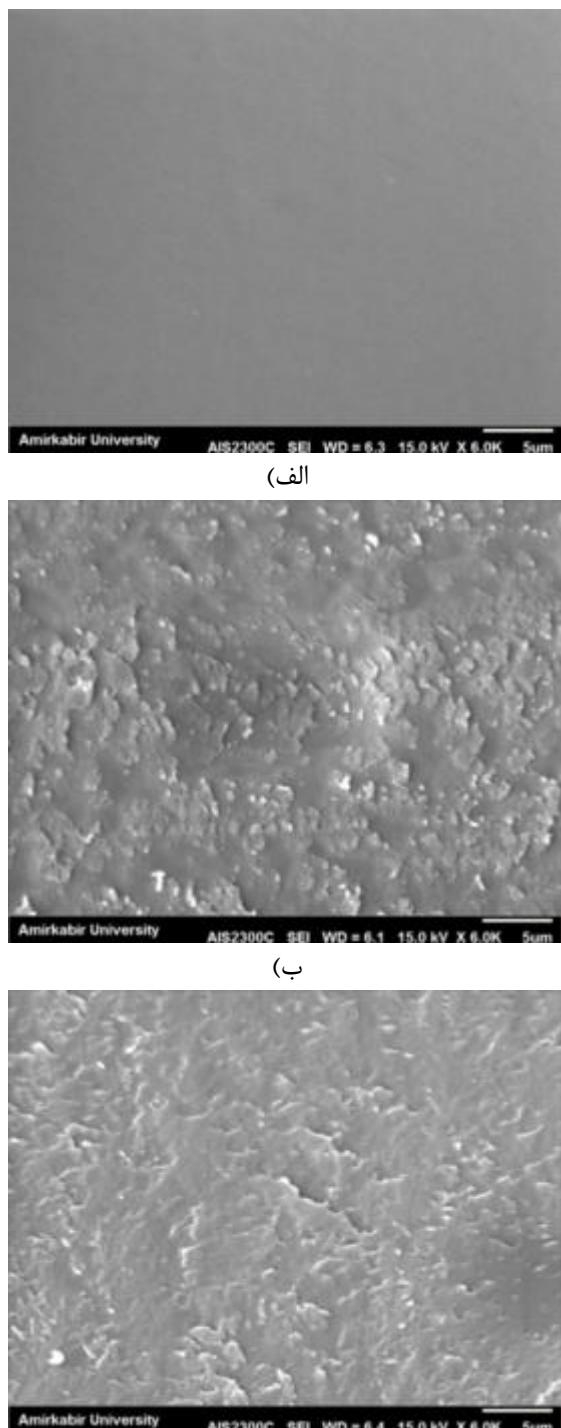

شکل ۱. میکروگراف های SEM لنز تماسی (الف) مرجع،  
ب) پرتودهی با ۱۰ ، ج) ۲۰ پالس

تماس برای لنز پرتودهی نشده  $75^\circ$  بوده که در نهایت با پرتودهی تا دوز  $1/9 \text{ J/cm}^2$  یا  $20$  پالس به  $64^\circ$  نزدیک و درنتیجه با کاهش زاویه تماس، آبدوستی سطح لنز را افزایش داده است.


#### ۴- نتیجه‌گیری

تابش لیزر اگزایمر آرگون فلوراید بر روی سطح لنزهای تماسی RGP، بدون ایجاد تغییر در ساختار شیمیایی، خواص سطحی لنز را بهبود بخشیده، زبری سطح را در پالس های بالاتر کاهش و آبدوستی سطح را افزایش داده است.

#### مراجع


- [1] Bennett, E. S., Henry, V. A., *Clinical Manual of Contact Lenses*, 3rd edition, University of New South Wales, 2009.
- [2] Pourakbar Saffar, A., *ArF excimer laser effect investigation on Cellulose Acetate and Polycarbonate membrane filters*, MSc thesis, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Sept 2009.
- [3] Jaleh, B., Parvin, P., “*Hydrophilicity and morphological investigation of polycarbonate irradiated by ArF excimer laser*”, *Nuclear Instrument & Meth B*, 265, 330-333, 2007.
- [4] Wisniewski, M., Sionkowska, A., Kaczmarek, H., “*The Influence of KrF Excimer Laser irradiation on the surface of collagen and collagen/PVP films*”, *International Journal of Photoenergy*, 1-7, 2006.
- [5] Naroo, S. A., Charman, W. N., “*Surface roughness after excimer laser ablation using a PMMA model: profilometry and effects on vision*”, *J Refract Surg*, 21(3): 260-8, 2005.
- [6] Wang, Z. K., Zheng, H. Y., Lim, C. P., Lam, Y. C., “*Irradiation Polymer surface wettability modification using femtosecond laser*”, *SIMTech technical reports*, 11, 1, 2010.
- [7] Hyung, S. S., Jun, K. J., “*Surface Modification of Rigid Gas Permeable Contact Lens Treated by Using a Low-Temperature Plasma in Air*”, *Journal of the Korean Physical Society*, 55, 6, 2436\_2440, 2009.

شیمیایی جدیدی در اثر پرتودهی به وجود نیامده است بلکه فقط شدت پیک‌ها به مقدار کمی دچار تغییر می‌شود. ارتعاش گره کربونیل در نزدیکی  $1727 \text{ cm}^{-1}$  شدید بوده که مثل باندهای مربوط به ارتعاش O-C-O گروه استیل در حدود  $1231 \text{ cm}^{-1}$  می‌باشد. همچنین پیک موجود در  $2961 \text{ cm}^{-1}$  مربوط به ارتعاش  $\text{CH}_3^-$  می‌باشد.

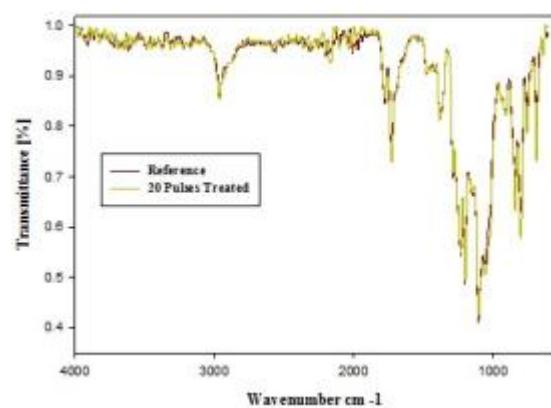

شکل ۳. طیف نشري FTIR لنز قبل و پس از پرتودهی با لیزر اگزایمر

زاویه تماس آب بر حسب افزایش تعداد پالس لیزری اندازه گیری و رسم شده که در شکل ۴ نشان داده شده است. مطابق شکل با افزایش دوز لیزر فرابنفش زاویه تماس در ابتدا در ۲ پالس افزایش و سپس به روند نزولی خود تا ۲۰ پالس ادامه داده است.

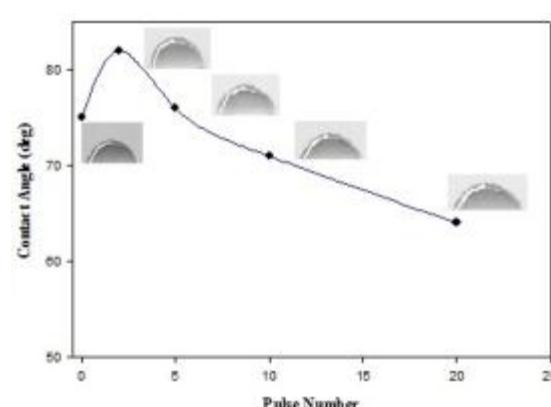

شکل ۴. منحنی تغییرات زاویه تماس سطح لنز بر حسب افزایش تعداد پالس لیزری

تغییراتی که در مورفولوژی سطح به وجود می‌آید، منجر به افزایش مقدار آب دوستی سطح لنز می‌شود. زاویه