



نانوکامپوزیت پلیمری شامل نانوسيم های مغناطیسی چند لایه ای نیکل / کبالت پوشانده شده با نانوذرات طلا به عنوان حسگر میدان مغناطیسی

بابک موسایی^۱، حسین نوروزی^۱، معصومه امینی^۱، فوزیه سهرابی^۱ و سیده مهری حمیدی^۱

^۱پژوهشکده لیزر و پلاسمما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده - نانوسيم های مغناطیسی به دلیل حساسیت بالایی که به تغییر مقدار و جهت میدان مغناطیسی دارند به عنوان حسگر میدان مغناطیسی مورد استفاده قرار گرفته اند. به این منظور نانوسيم های چند لایه ای نیکل کبالت با استفاده از روش الکتروشیمیایی تولید شده و پس از تشکیل نانوکامپوزیت پلیمری شفاف مورد سنجه بیضی سنجی پلاسمونی در قدرت های میدان مختلف قرار گرفتند. نتایج حاصل از اندازه گیری نشان دهنده توانایی تشخیص قدرت میدان مغناطیسی با استفاده از کمیت بیضی سنجی پلاسمونی است. همچنین نانوسيمهای پوشانده شده با طلا نیز با استفاده از جابجایی طیفی در پاسخ بیضی سنجی، توانایی خود را در تشخیص قدرت میدان خارجی به اثبات رسانده اند.

کلید واژه-نانوسيم های چند لایه ای، بیضی سنجی مگنتوپلاسمونی، حسگر میدان مغناطیسی.

Polymeric nano-composite contains of gold coated multilayer Ni/Co nanowires as a magnetic field sensor


Babak Mosaei, Hosein Norouzi, Masomeh Amini, Foozieh Sohrabi, Seyedeh Mehri Hamidi

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Abstract- magnetic nanowires because their sensitivity to the amount and direction of external magnetic field has been used as a magnetic field sensor. For this reason we prepare magnetic nanowires by electrochemical method and after align them in poly-dimethylsiloxane matrix, we characterize the samples in magneto-plasmonic ellipsometry experimental setup. our results show the good sensitivity of ellipsometry parameter to the external magnetic field strength. Also gold coated nanowires show the magnetic field sensor ability by spectral shift in the ellipticity parameter.

Keywords: Multilayer nanowires, magnetoplasmonic ellipsometry, magnetic field sensor.

با بعد از یکسان تولید شده و مورد سنجش عنصری و اندازه گیری میکروسکوپ الکترونی قرار گرفتند که می توان در شکل ۱ تصویر میکروسکوپ الکترونی و آنالیز عنصری از نانوسيم ها که نشان دهنده ترکيب ۵۰ به ۵۰ درصد نیکل و کبات در نانوسيم چهار لایه ای Ni/Co است را مشاهده نمود.

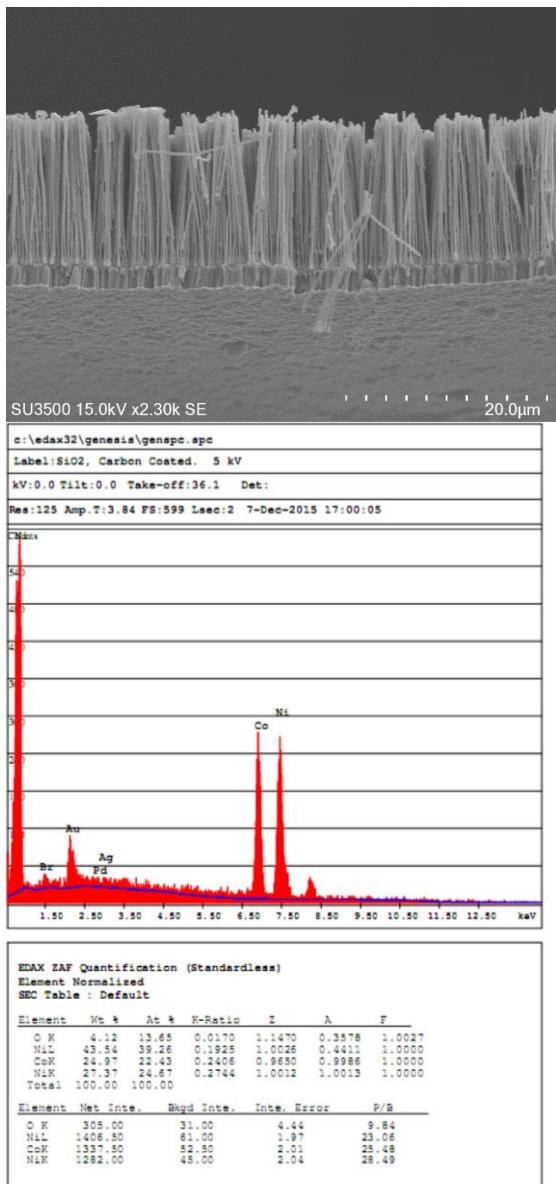

شکل ۱: تصویر میکروسکوپ الکترونی و آنالیز عنصری نانوسيم های نیکل/کبات چهار لایه ای.

برای اطمینان از روند انباست و بررسی نانوسيم-ها تصویر برداری از آن-ها ضروری می-نمود. به همین منظور مجبور به رها سازی نانوسيم-ها بودیم. برای این کار، ابتدا باید کروم، مس و طلای لایه نشانی شده پشت قالب را حذف


۱- مقدمه

نانوسيم ها در مقایسه با ذرات کروی دارای ناهمسانگردی شکلی هستند و قابلیت کنترل ترکیبات گوناگون در امتداد طولی آنها وجود دارد. نانوسيم های فرومغناطیس خواص تک محوری و تنظیم پذیر دارند که با مواد فرومغناطیس توهد ای و فیلم های نازک و ذرات کروی متفاوت است. همچنین می-توان نانوسيم ها را از یک یا چند عنصر به صورت مغناطیسی و یا آلیاژی تهیه نمود. در ساخت این ترکیبات، امکان ساخت تک جزئی و چند جزئی وجود دارد. خواص مغناطیسی همچون راستای محور آسان مغناطش، دمای کوری، میدان اشباع، مغناطش اشباع، مغناطش پسماند با تغییر قطر، ترکیبات، ضخامت لایه ها در نانوسيم های چندگانه فرومغناطیس قابل کنترل هستند [۳-۱]. به دلیل این حساسیت در نانوسيم ها، می توان از آنها به عنوان حسگر میدان مغناطیسی استفاده نمود. اما بهره گیری از این نانوسيم ها به عنوان حسگر میدان مغناطیسی در چیدمان های اپتیکی، نیاز به جانشانی این هسته حسگر در ترکیبات شفاف دارد. به همین دلیل ایده استفاده از نانوسيم ها در پلیمر شفاف پلی دی متیل سیلکسان مطرح گردید [۴]. در این گزارش نیز از این ترکیبات شفاف بهره برده شده و پس از تولید نانوسيم های مغناطیسی چند لایه ای، از آن ها به عنوان حسگر میدان مغناطیسی در محدوده مرئی استفاده می شود.

۲- ساختار حسگر پیشنهادی


قالب آلومنیای مورد استفاده برای تولید نانوسيم ها، قالب های واتمن بوده که ضخامت قالب ۶۰ میکرومتر و میانگین قطر حفره ها ۱۰۰ نانومتر و فاکتور پرشدگی آنها برابر ۴۰٪ می باشد. یک طرف قالب را با لایه نشانی کروم (۲۰ نانومتر)، مس (۸۰۰ نانومتر) و طلا (۲۰۰ نانومتر) مسدود می کنیم تا از آن به عنوان کاتد بهره بگیریم. نانوسيم های چند لایه ای کبات / نیکل به روش الکترو انباست شیمیابی درون دایره ای به قطر ۶ میلیمتر با استفاده از محلول انباست با pH=3.5 متشکل از سولفات کبات هفت آبه (۳۰۰ گرم بر لیتر)، اسید بوریک (۴۵ گرم بر لیتر) رشد داده شدند. ولتاژ اعمالی برای الکتروانباست شیمیابی ۲- ولت در دمای اتاق می باشد. نانوسيم های چند لایه ای نیکل / کبات به صورت چهار لایه

می-کردیم. برای حذف طلا، قالب را به مدت ۳-۶ دقیقه در داخل محلول KI قرار دادیم. سپس نوبت به حذف مس می-رسد که بهترین گزینه برای حذف آن با سرعت پایین خورنده-۱۱-۱۰۰ ASP است. سرعت این خورنده برای حذف مس تقریباً در بازه-۸ ۱۶-۸ نانومتر برثانیه است. بعد از حذف طلا، قالب را به مدت ۳-۶ دقیقه در داخل ASP-100 قرار می-دهیم. لازم به ذکر است که این خورنده لایه کروم را نیز حذف می-کند، چون ضخامت کروم بسیار ناچیز است. بعد از حذف شدن مس و کروم نوبت به حذف خود قالب آنودایز آلومینیوم اکسید می-رسد. برای حذف قالب از محلول سود ۶ مولار استفاده می-کنیم. بطوری-که قالب را در داخل ویال قرار داده و سود را به آن اضافه می-کنیم بعد از ۳-۲ دقیقه اولین نشانه های حل شدن قالب دیده می-شود. برای تکمیل فرایند ۹-۸ دقیقه زمان لازم است. بعد از رهاشدن کامل نانوسيم ها به آرامی محلول سود را خارج نموده و با درصد حجمی معینی وارد پلیمر دی متیل سیلوکسان نموده و در حضور میدان مغناطیسی خارجی ترکیب نانوکامپوزیت شفافی از ترکیب نانوسيم های به خط شده به صورت شکل ۲ تشکیل گردید.

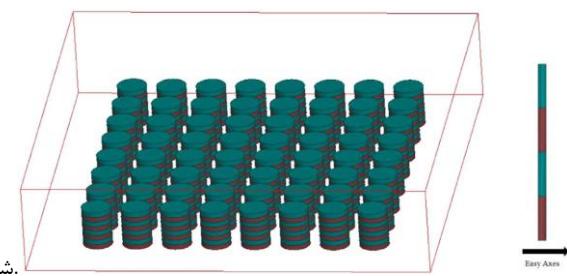


کل ۲: طرحواره نانوسيم های به خط شده و رها سازی شده در پلی دی متیل سیلوکسان.

در نهایت نمونه آماده شده را در نمک طلا چهار آبه رها سازی نموده و پس از تشکیل نانوذرات در ترکیب نانوکامپوزیتی جدید، نمونه ها را در چیدمان اندازه گیری بیضی سنجی مگنتوپلاسمونی قرار دادیم (شکل ۳). در این چیدمان، نمونه ها تحت تاثیر میدان های مغناطیسی خارجی به قدرت های ۵۵/۱ میلی تسلا و ۲/۸۳ میلی تسلا به عنوان میدان های قوى و ضعيف قرار گرفته و در بازه طیفي مرئی بیضی سنجی گردیدند.

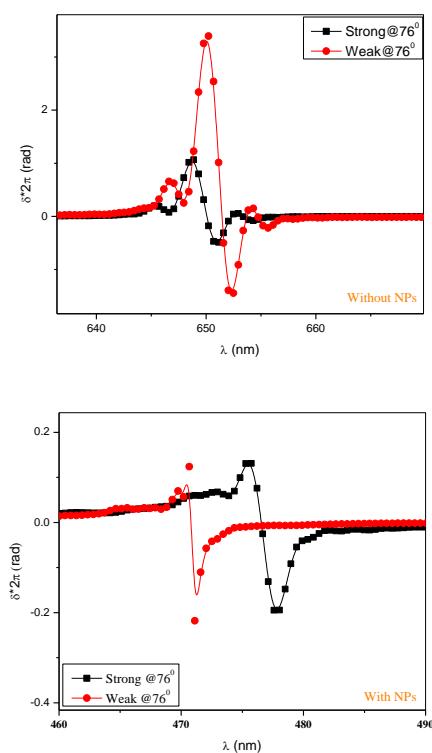

۹۶۷
WW معابر است.

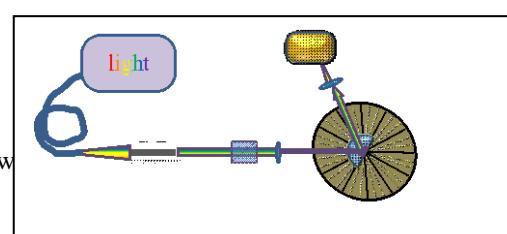

این

ترکیب پلیمری استفاده شده و ترکیب جدیدی با توجه به منبع نوری موجود می‌توان پیشنهاد داد.

۴- نتیجه‌گیری



در این گزارش، نانوکامپوزیت پلیمری شامل نانوسیم‌های مغناطیسی چهار لایه ای نیکل/کبات آمده شده و به عنوان حسگر میدان مغناطیسی در چیدمان بیضی سنجی مگنتوپلاسمونی مورد سنجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از اندازه گیریها نشان دهنده توانایی تشخیص قدرت میدان مغناطیسی نمونه شامل نانوسیم‌های مغناطیسی با افزایش قدرت سیگنال بیضی سنجی پلاسمونی با کاهش قدرت میدان است. همچنین ورود نانوذرات طلا در ساختار، توانایی تشخیص قدرت میدان با استفاده از جابجایی طول موجی را فراهم می‌نماید. میزان حساسیت این ترکیبات نوظهور در زمینه سنجه میدان مغناطیسی، با توجه به عرض باند در نصف بیشینه سیگنال‌ها قابل مقایسه خواهد بود.

مراجع

- [1] H. Zeng, R. Skomski, L. Menon, Y. Liu, S. Bandyopadhyay, D. Sellmyer, J. Phys. Rev. B 65 (2002) 134426.
- [2] M. Tian, J. Wang, J. Kurtz, T.E. Mallouk, M.H.W. Chan, Nano Lett. 3 (2003) 919.
- [3] D.J. Sellmyer, M. Zheng, R.J. Skomski, J. Phys. Condens. Matter 13 (2001) R433.
- [4] S. M. Hamidi, A. Sobhani, A. Aftabi, M. Najafi, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 374 (2015) 139.
- [5] F. Sohrabi, S. M. Hamidi, Submitted in Langmuir, 2017.

شکل ۴: طیف تغییرات ضریب بیضی سنجی مگنتوپلاسمونی نمونه شامل ۴ لایه نیکل/کبات در هندسه عمود.

همچنانکه از نمودار تغییرات بر می‌آید، در نمونه شامل نانوسیم چهار لایه ای، اختلاف بین ضریب بیضی سنجی مگنتوپلاسمونی در دو حد میدان ضعیف و قوی با حفظ شکل شبه فانو، زیاد است که نشان دهنده حساسیت بالای نمونه‌ها در هندسه عمود به دلیل غالب بودن سهم ناهمسانگردی شکلی می‌باشد. از سوی دیگر جابجایی طول موجی ایجاد شده در دو حد میدان در نمونه بدون نانوذرات طلا کمتر است.

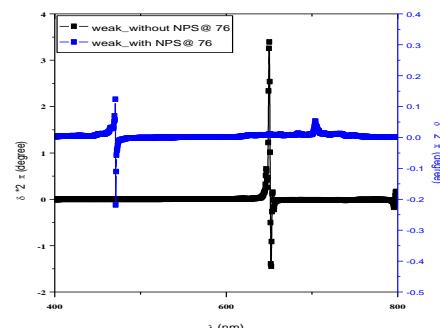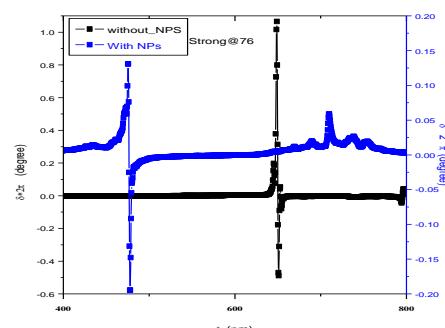

شکل ۵: طیف تغییرات ضریب بیضی سنجی مگنتوپلاسمونی نمونه شامل ۴ لایه نیکل/کبات در هندسه عمود و در دو میدان قوی و ضعیف در حضور و عدم حضور نانوذرات طلا.

در شکل ۵ می‌توان تغییرات پاسخ بیضی سنجی مگنتوپلاسمونی در نمونه‌ها را به ازای ورود نانوذرات طلا در کامپوزیت اولیه به صورت جابجایی آبی به اندازه تقریباً ۲۰۰ نانومتری ملاحظه کرد. در واقع ورود نانوذرات به نمونه، لیزر مورد نیاز جهت ثبت داده را تعویض می‌کند که می‌تواند نقطه قوتی برای ایده ورود نانوذرات باشد. چرا که با یک گام و بدون نیاز به هیچ عامل اضافه‌ای، از کاهنده موجود در